

## CERTIFICADO DE CALIBRACION

### CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

**INSTRUMENTO :** DATALOGGER DE TEMPERATURA

**FABRICANTE :** AUTOMATISMOS TEINCO

**MODELO :** 22T

**Nº DE SERIE :** 2A0000006E462941

**ESCALA :** 0+125 °C

**DIVISION ESCALA :** 0,01

**INMERSION :** TOTAL

**CODIGO INTERNO:** -

**PETICIONARIO :** UVE, S.A.  
AV.MONTE BOYAL 237  
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE

**FECHA CALIBRACION :** 30/09/2020  
**FECHA PROXIMA CALIBRACION :** 30/09/2021  
**(RECOMENDADA)**

### PROCESO DE CALIBRACION

1.PATRON UTILIZADO: **TERMOMETRO DE LECTURA DIRECTA CON Sonda PT-100.**

MARCA DELTA OHM  
MODELO HD 2107.1 / TP 472 I.0  
Nº DE SERIE 08008352/08008153  
CERTIFICADO LT-200767-1

2. PROCEDIMIENTO UTILIZADO: PROCEDIMIENTO INTERNO TEINCO P.G.C.-TER-96.02.


3. CONDICIONES AMBIENTALES:

TEMP. AMBIENTE	22	°C
HUMEDAD REL.	54	%

## RESULTADO DE LA CALIBRACION :

Se considerara la lectura del instrumento en la siguiente tabla como la media de los 4 valores tomados para cada temperatura de referencia en la calibración.

TEMPERATURA DE REFERENCIA °C	LECTURA INSTRUMENTO °C	CORRECCION °C	INCERTIDUMBRE °C
89,97	89,95	0,02	0,05
100,01	100,08	-0,07	0,05
110,03	110,03	0,00	0,05
115,05	115,03	0,02	0,05
120,06	119,97	0,09	0,05

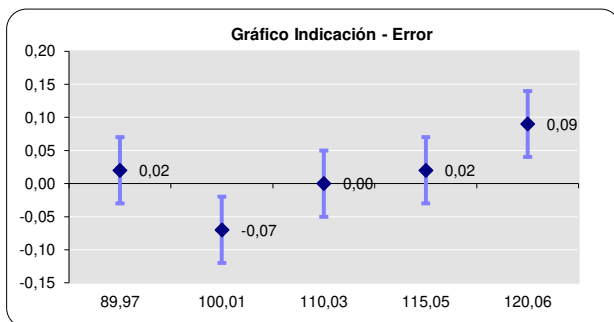

## EXACTITUD E INCERTIDUMBRE:

1. Para la **EXACTITUD**: La correccion maxima que se debe efectuar es de : **0,09 °C**

2. Para la **INCERTIDUMBRE**: Se han considerado para su cálculo, las contribuciones de los patrones utilizados, el método de calibración, el propio instrumento calibrado y las condiciones ambientales. En base a estos datos, la incertidumbre asociada a la calibración es:

INCERTIDUMBRE TOTAL ASOCIADA = **0,05 °C**

En función de los datos obtenidos en la calibración, las desviaciones que presenta el equipo, para las condiciones definidas en el ensayo, se encuentran en el intervalo:

DE: ±	0,05	°C
A: ±	0,14	°C

Las incertidumbres asignadas corresponden a un nivel de fiabilidad no inferior al 95% K=2 según documento EA-4/02

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que realizaron las mediciones.

LABORATORIO DE CONTROL :

Fdo: CARMEN DURÁN

**AUTOMATISMOS TEINCO,S.L.**



Fecha de extensión del Certificado de Calibración :

Vigo, a 30 de septiembre de 2020.

TEINCO S.L.  
AUTOMATISMOS